

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 3 月 2 6 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 8 6 6 2 1
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 8 6 6 2 1]


出 願 人 ソニー株式会社
Applicant(s):



2 0 0 3 年 1 2 月 1 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 0390226506

【提出日】 平成15年 3月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B25J 1/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社
内

【氏名】 大橋 武史

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社
内

【氏名】 芦ヶ原 隆之

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社
内

【氏名】 福地 正樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社
内

【氏名】 日台 健一

【特許出願人】

【識別番号】 000002185

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代理人】

【識別番号】 100093241

【弁理士】

【氏名又は名称】 宮田 正昭

【選任した代理人】

【識別番号】 100101801

【弁理士】

【氏名又は名称】 山田 英治

【選任した代理人】

【識別番号】 100086531

【弁理士】

【氏名又は名称】 澤田 俊夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 048747

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9904833

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ステレオ・カメラ診断補助装置、並びにロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

ロボットに搭載されたステレオ・カメラの診断を支援するステレオ・カメラ診断補助装置であって、

ステレオ・カメラ診断用のテクスチャが設けられた略平面状の表面部と、

前記表面部に設けられた、前記ロボットの脚底を設置する場所を指示する指示部と、

を具備することを特徴とするステレオ・カメラ診断補助装置。

【請求項 2】

前記ステレオ・カメラ診断補助装置は折り畳み構造をなし、該折り畳み構造の開成時に略平面状となり、前記表面部を露出する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載のステレオ・カメラ診断補助装置。

【請求項 3】

前記表面部は、テンプレート・マッチングによるステレオ・カメラ・システムの場合、テンプレート内のテクスチャが、エピポーラ・ライン上で正しくマッチングを行なえるようなテクスチャを備える、

ことを特徴とする請求項 1 に記載のステレオ・カメラ診断補助装置。

【請求項 4】

前記表面部は、診断、キャリブレーションにおいて誤マッチングを避けられるようなテクスチャを備える、

ことを特徴とする請求項 1 に記載のステレオ・カメラ診断補助装置。

【請求項 5】

前記表面部は、均一なテクスチャに斜線を入れたパターンを持つ、
ことを特徴とする請求項 1 に記載のステレオ・カメラ診断補助装置。

【請求項 6】

前記表面部は、幾何形状が既知となるキャリブレーション・パターンを備える

ことを特徴とする請求項 1 に記載のステレオ・カメラ診断補助装置。

【請求項 7】

ロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法であって、
所定のテクスチャを持つ診断用マット上に載せたロボットが該診断用マットを撮影するために適した姿勢をとるステップと、
前記ステレオ・カメラにおいて取得した画像を基に距離画像を生成するステップと、
前記生成された距離画像から前記診断用マットの平面を検出するステップと、
前記検出した平面の平面度を測定し、該平面度が基準平面度より高いかどうかに応じて、ステレオ・カメラの性能を検証するステップと、
を具備することを特徴とするロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法。

【請求項 8】

前記のステレオ・カメラの性能を検証するステップでは、前記生成された距離画像に基づいて前記診断用マットを構成する平面の方程式を求め、前記診断用マットの各点と該平面との距離の偏差に基づいて、該平面度が基準平面度より高いかどうかを判定する、
ことを特徴とする請求項 7 に記載のロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法。

【請求項 9】

ロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法であって、
所定のテクスチャを持つ診断用マット上に載せたロボットが該診断用マットを撮影するために適した姿勢をとるステップと、
前記ステレオ・カメラにおいて取得した画像を基に距離画像を生成するステップと、
ロボットの関節のキネマティクスを解くことによって、床面座標系を基準としたカメラ座標系への変換式を求め、該変換式に基づいてカメラ座標系を基準とした床面の平面の方程式を求めるステップと、

ステレオ・カメラによる距離値とキネマティクスによる平面とを比較することにより、ステレオ・カメラを診断するステップと、
を具備することを特徴とするロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法。

【請求項 1 0】

ロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法であって、
均一のテクスチャに斜線が施された診断用マット上に載せたロボットが該診断用マットを撮影するために適した姿勢をとるステップと、
前記ステレオ・カメラにおいて取得した画像を基に距離画像を生成するステップと、
斜線付近の距離値と基準平面を比較し、両者の差異に基づいてステレオ・カメラを診断するステップと、
を具備することを特徴とするロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法。

【請求項 1 1】

ロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法であって、
所定のテンプレートを含んだテクスチャを持つ診断用マット上に載せたロボットが該診断用マットを撮影するために適した姿勢をとるステップと、
前記ステレオ・カメラにおいて基準カメラ画像及び検出カメラ画像を取得するステップと、
基準カメラ画像中のテンプレートを、検出カメラ画像中でエピポーラ・ラインに沿って探索し、それぞれのテンプレートに対してエピポーラ・ラインに沿って、
、相関値を表すマッチング・スコアを得るステップと、
マッチング・スコア値と基準値の比較結果に基づいて、エピポーラ・ラインのずれを判定するステップと、
を具備することを特徴とするロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法。

【請求項 1 2】

ロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法であって、

所定のテンプレートを含んだテクスチャを持つ診断用マット上に載せたロボットが該診断用マットを撮影するために適した姿勢をとるステップと、

前記ステレオ・カメラにおいてキャリブレーションに必要な枚数の画像を取得するステップと、

取得された複数枚の画像を用いて前記ステレオ・カメラのキャリブレーション・パラメータを算出するステップと、
を具備することを特徴とするロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、所定の位置関係を持つ複数の視点（投影中心）から撮像した画像を用いて撮像画像中の各点と投影中心との距離を三角測量の原理により測定するステレオ・カメラの診断を支援するステレオ・カメラ診断補助装置並びにステレオ・カメラの診断方法に係り、特に、ロボットに搭載されたステレオ・カメラの診断を支援するステレオ・カメラ診断補助装置、並びにロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法に関する。

【0002】

さらに詳しくは、本発明は、ロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの経年変化や機体の転倒などに伴うカメラ位置ずれなどの診断を支援するステレオ・カメラ診断補助装置、並びにロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法に係り、特に、インテリジェントなロボット装置の自動診断機能を用いてステレオ・カメラを診断する際のステレオ・カメラ診断補助装置、並びにロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法に関する。

【0003】

【従来の技術】

電氣的若しくは磁氣的な作用を用いて人間の動作に似せた運動を行う機械装置のことを「ロボット」という。ロボットの語源は、スラブ語の R O B O T A（奴隷機械）に由来すると言われている。最近では、ヒトのような2足直立歩行を行

う動物の身体メカニズムや動作をモデルにしてデザインされた「人間形」若しくは「人間型」のロボット (humanoid robot) を始めとして、各種の脚式移動ロボットに関する研究開発が進展し、実用化への期待も高まってきている。

【0004】

人間の作業空間や居住空間のほとんどは、2足直立歩行という人間が持つ行動様式に合わせて形成されている。言い換えれば、人間の住空間は、車輪などを移動手段とした現状の機械システムが移動するには多くの障壁が存在する。ロボットがさまざまな人的作業を支援又は代行し、さらに人間の住空間に深く浸透していくためには、ロボットの移動可能範囲が人間のそれとほぼ同じであることが好ましい。これが、脚式移動ロボットの実用化が大いに期待されている所以でもある。

【0005】

このような人間型ロボットを、産業活動・生産活動などにおける各種作業の代行に適用することができる。例えば、原子力発電プラントや火力発電プラント、石油化学プラントにおけるメンテナンス作業、製造工場における部品の搬送・組立作業、高層ビルにおける清掃、火災現場その他における救助といったような、人間が容易に踏み込むことができない現場での危険作業・難作業を人間型ロボットに代行してもらう。

【0006】

また、人間型ロボットの他の用途として、人間と居住空間を同一にする「共生」、若しくは「エンターテインメント」と呼ばれるものが挙げられる。この種の用途では、ロボットは、家庭環境など人と同じ作業環境に設置されて利用に供される。この場合、作業代行などの生活支援というよりも、生活密着という性格が濃厚である。

【0007】

インテリジェントな移動ロボットは、自律的な思考及び動作制御を行なうとともに、動作生成の時系列モデルに従って自律的な動作を実行することができる。また、ロボットが画像入力装置や音声入出力装置を装備し、画像処理や音声処理により環境認識を行なうことにより、自律的な動作や作業範囲を拡張したり、よ

り高度な知的レベルで人間とのリアリスティックなコミュニケーションを実現したりすることが可能となる。

【0008】

例えば、移動ロボットが画像入力並びに画像処理・画像認識機能を装備することにより、ロボットは作業環境内の各場所におかれたランドマークを検出して所定の動作を実行することができるので、無人状態でもロボットを誘導することができる。

【0009】

さらに、ロボットが画像入力装置としてステレオ・カメラを搭載することにより、作業空間に散在する障害物までの距離をより正確に把握してこれを回避したり、床面を特定したりその凹凸を認識して、歩行経路の修正や姿勢安定制御に活用することができる。ステレオ・カメラは、所定の位置関係に保たれた異なる視点（投影中心）を持つ複数（多くは2台）のカメラで構成され、撮像画像中の各点と投影中心との距離を三角測量の原理により測定することができる。

【0010】

ところで、2足の脚式移動ロボットは、冗長な自由度を含む多リンク系により構成されており、このような特徴を生かし、複雑な動作を行なうことが可能であるとともに、移動・バランス維持・アーム作業といった複数のタスクを同時実行することができる。その反面、姿勢安定性を保つことが困難であり、歩行やその他の脚式作業中において、転倒してしまうことが想定される。

【0011】

例えば、ロボットの頭部にステレオ・カメラが搭載されている場合、カメラが破損してしまわなくとも、カメラの相対位置が変化し、ステレオ距離計測が正しく行なえなくなる、という問題がある。また、転倒やその他の衝撃が印加されなくとも、経年変化によってもカメラの相対位置が変化する可能性がある。

【0012】

再度キャリブレーションを行なうことでステレオ・カメラの性能を取り戻すことができるが、特殊な治具が必要となり、工数・時間・技術の点で容易に行なえるものではない。

【0013】

また、左右のカメラから得られる画像中の適当な対応点を用いて簡単に再キャリブレーションを行なう方法なども提案されているが、キャリブレーション精度の点で問題がある。

【0014】**【発明が解決しようとする課題】**

本発明の目的は、ロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの経年変化や機体の転倒などに伴うカメラ位置ずれなどの診断を支援することができる、優れたステレオ・カメラ診断補助装置、並びにロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法を提供することにある。

【0015】**【課題を解決するための手段及び作用】**

本発明は、上記課題を参酌してなされたものであり、その第1の側面は、ロボットに搭載されたステレオ・カメラの診断を支援するステレオ・カメラ診断補助装置であって、

ステレオ・カメラ診断用のテクスチャが設けられた略平面状の表面部と、

前記表面部に設けられた、前記ロボットの脚底を設置する場所を指示する指示部と、

を具備することを特徴とするステレオ・カメラ診断補助装置である。

【0016】

前記ステレオ・カメラ診断補助装置は折り畳み構造をなし、該折り畳み構造の開成時に略平面状となり、前記表面部を露出するように構成することができる。

【0017】

ここで、前記表面部は、テンプレート・マッチングによるステレオ・カメラ・システムの場合、テンプレート内のテクスチャが、エピポーラ・ライン上で正しくマッチングを行なえるようなテクスチャを備えている。

【0018】

テクスチャは、例えば、ランダム・ドット・パターン、フラクタル、自然画などの、均一で繰り返しの無いパターンなど、診断、キャリブレーションにおいて

誤マッチングを避けられるようなものであることが好ましい。

【0019】

また、前記表面部は、均一なテクスチャに斜線を入れたパターンを持つことにより、高精度なステレオ・カメラ診断に用いることができる。

【0020】

また、前記表面部は、幾何形状が既知となるキャリブレーション・パターンを備えていてもよい。

【0021】

また、本発明の第2の側面は、ロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法であって、

所定のテクスチャを持つ診断用マット上に載せたロボットが該診断用マットを撮影するために適した姿勢をとるステップと、

前記ステレオ・カメラにおいて取得した画像を基に距離画像を生成するステップと、

前記生成された距離画像から前記診断用マットの平面を検出するステップと、

前記検出した平面の平面度を測定し、該平面度が基準平面度より高いかどうかに応じて、ステレオ・カメラの性能を検証するステップと、

を具備することを特徴とするロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法である。

【0022】

ここで、検出された平面の平面度が基準となる平面度より高い場合は、ステレオ・カメラの性能が十分あるとして、診断はOKとなる。一方、検出された平面の平面度が低い場合は、ステレオ・カメラの性能が不十分であるとして、診断はNGとなる。

【0023】

前記のステレオ・カメラの性能を検証するステップでは、前記生成された距離画像に基づいて前記診断用マットを構成する平面の方程式を求め、前記診断用マットの各点と該平面との距離の偏差に基づいて、該平面度が基準平面度より高いかどうかを判定するようにしてもよい。

【0024】

また、本発明の第3の側面は、ロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法であって、

所定のテクスチャを持つ診断用マット上に載せたロボットが該診断用マットを撮影するために適した姿勢をとるステップと、

前記ステレオ・カメラにおいて取得した画像を基に距離画像を生成するステップと、

ロボットの関節のキネマティクスを解くことによって、床面座標系を基準としたカメラ座標系への変換式を求め、該変換式に基づいてカメラ座標系を基準とした床面の平面の方程式を求めるステップと、

ステレオ・カメラによる距離値とキネマティクスによる平面とを比較することにより、ステレオ・カメラを診断するステップと、
を具備することを特徴とするロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法である。

【0025】

ここで、検出された平面の平面度がカメラ座標系の平面度より高い場合は、ステレオ・カメラの性能が十分あるとして、診断はOKとなる。一方、検出された平面の平面度が低い場合は、ステレオ・カメラの性能が不十分であるとして、診断はNGとなる。

【0026】

また、本発明の第4の側面は、ロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法であって、

均一のテクスチャに斜線が施された診断用マット上に載せたロボットが該診断用マットを撮影するために適した姿勢をとるステップと、

前記ステレオ・カメラにおいて取得した画像を基に距離画像を生成するステップと、

斜線付近の距離値と基準平面を比較し、両者の差異に基づいてステレオ・カメラを診断するステップと、

を具備することを特徴とするロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断

方法である。

【0027】

ここで、距離値と基準平面との差異が閾値以内であれば、ステレオ・カメラの性能が十分あるとして、診断はOKとなる。一方、閾値を越える場合には、ステレオ・カメラの性能が不十分であるとして、診断はNGとなる。

【0028】

また、本発明の第5の側面は、ロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法であって、

所定のテンプレートを含んだテクスチャを持つ診断用マット上に載せたロボットが該診断用マットを撮影するために適した姿勢をとるステップと、

前記ステレオ・カメラにおいて基準カメラ画像及び検出カメラ画像を取得するステップと、

基準カメラ画像中のテンプレートを、検出カメラ画像中でエピポーラ・ラインに沿って探索し、それぞれのテンプレートに対してエピポーラ・ラインに沿って、相関値を表すマッチング・スコアを得るステップと、

マッチング・スコア値と基準値の比較結果に基づいて、エピポーラ・ラインのずれを判定するステップと、

を具備することを特徴とするロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法である。

【0029】

ここで、エピポーラ・ラインのずれが十分に小さければ、ステレオ・カメラの性能が十分あるとして、診断はOKとなる。一方、エピポーラ・ラインのずれが大きい場合には、ステレオ・カメラの性能が不十分であるとして、診断はNGとなる。

【0030】

また、本発明の第6の側面は、ロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法であって、

所定のテンプレートを含んだテクスチャを持つ診断用マット上に載せたロボットが該診断用マットを撮影するために適した姿勢をとるステップと、

前記ステレオ・カメラにおいてキャリブレーションに必要な枚数の画像を取得するステップと、

取得した複数枚の画像を用いて前記ステレオ・カメラのキャリブレーション・パラメータを算出するステップと、
を具備することを特徴とするロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法である。

【0031】

本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施形態や添付する図面に基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。

【0032】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳解する。

【0033】

A. ロボット構成

図1には、本発明に実施に供されるロボット装置1の機能構成を模式的に示している。同図に示すように、ロボット装置1は、全体の動作の統括的制御やその他のデータ処理を行なう制御ユニット20と、入出力部40と、駆動部50と、電源部60とで構成される。以下、各部について説明する。

【0034】

入出力部40は、入力部としてロボット装置1の目に相当するカメラ15や、耳に相当するマイクロフォン16、頭部や背中などの部位に配設されてユーザの接触を感知するタッチ・センサ18、あるいは五感に相当するその他の各種のセンサを含む。また、出力部として、口に相当するスピーカ17、あるいは点滅の組み合わせや点灯のタイミングにより顔の表情を形成するLEDインジケータ（目ランプ）19などを装備している。これら出力部は、音声やランプの点滅など、脚などによる機械運動パターン以外の形式でもロボット装置1からのユーザ・フィードバックを表現することができる。

【0035】

ここで、カメラ15は、所定の位置関係に保たれた異なる視点（投影中心）を

持つ 2 台のカメラによりステレオ・カメラを構成し、撮像画像中の各点と投影中心との距離を三角測量の原理により測定することができる。

【0 0 3 6】

駆動部 5 0 は、制御部 2 0 が指令する所定の運動パターンに従ってロボット装置 1 の機体動作を実現する機能ブロックであり、行動制御による制御対象である。駆動部 5 0 は、ロボット装置 1 の各関節における自由度を実現するための機能モジュールであり、それぞれの関節におけるロール、ピッチ、ヨーなど各軸毎に設けられた複数の駆動ユニットで構成される。各駆動ユニットは、所定軸回りの回転動作を行なうモータ 5 1 と、モータ 5 1 の回転位置を検出するエンコーダ 5 2 と、エンコーダ 5 2 の出力に基づいてモータ 5 1 の回転位置や回転速度を適応的に制御するドライバ 5 3 の組み合わせで構成される。

【0 0 3 7】

駆動ユニットの組み合わせ方によって、ロボット装置 1 を例えば 2 足歩行又は 4 足歩行などの脚式移動ロボットとして構成することができる。

【0 0 3 8】

電源部 6 0 は、その字義通り、ロボット装置 1 内の各電気回路などに対して給電を行なう機能モジュールである。本実施形態に係るロボット装置 1 は、バッテリーを用いた自律駆動式であり、電源部 6 0 は、充電バッテリー 6 1 と、充電バッテリー 6 1 の充放電状態を管理する充放電制御部 6 2 とで構成される。

【0 0 3 9】

充電バッテリー 6 1 は、例えば、複数本のリチウムイオン 2 次電池セルをカートリッジ式にパッケージ化した「バッテリー・パック」の形態で構成される。

【0 0 4 0】

また、充放電制御部 6 2 は、バッテリー 6 1 の端子電圧や充電／放電電流量、バッテリー 6 1 の周囲温度などを測定することでバッテリー 6 1 の残存容量を把握し、充電の開始時期や終了時期などを決定する。充放電制御部 6 2 が決定する充電の開始及び終了時期は制御ユニット 2 0 に通知され、ロボット装置 1 が充電オペレーションを開始及び終了するためのトリガとなる。

【0 0 4 1】

制御ユニット 2 0 は、「頭脳」に相当し、例えばロボット装置 1 の機体頭部あるいは胴体部に搭載されている。

【 0 0 4 2 】

図 2 には、制御ユニット 2 0 の構成をさらに詳細に図解している。同図に示すように、制御ユニット 2 0 は、メイン・コントローラとしての C P U (Central Processing Unit) 2 1 が、メモリやその他の各回路コンポーネントや周辺機器とバス接続された構成となっている。バス 2 7 は、データ・バス、アドレス・バス、コントロール・バスなどを含む共通信号伝送路である。バス 2 7 上の各装置にはそれぞれに固有のアドレス（メモリ・アドレス又は I / O アドレス）が割り当てられている。C P U 2 1 は、アドレスを指定することによってバス 2 8 上の特定の装置と通信することができる。

【 0 0 4 3 】

R A M (Random Access Memory) 2 2 は、D R A M (Dynamic RAM) などの揮発性メモリで構成された書き込み可能メモリであり、C P U 2 1 が実行するプログラム・コードをロードしたり、実行プログラムによる作業データの一時的な保存したりするために使用される。

【 0 0 4 4 】

R O M (Read Only Memory) 2 3 は、プログラムやデータを恒久的に格納する読み出し専用メモリである。R O M 2 3 に格納されるプログラム・コードには、ロボット装置 1 の電源投入時に実行する自己診断テスト・プログラムや、ロボット装置 1 の動作を規定する動作制御プログラムなどが挙げられる。

【 0 0 4 5 】

ロボット装置 1 の制御プログラムには、ステレオ・カメラ 1 5 やマイクロフォン 1 6 などのセンサ入力処理してシンボルとして認識する「センサ入力・認識処理プログラム」や、短期記憶や長期記憶などの記憶動作を司りながらセンサ入力と所定の行動制御モデルとに基づいてロボット装置 1 の行動を制御する「行動制御プログラム」、行動制御モデルに従って各関節モータの駆動やスピーカ 1 7 の音声出力などを制御する「駆動制御プログラム」、さらにはステレオ・カメラ 1 5 の診断やキャリブレーションを行なうための機体動作を行なう「カメラ診断

／キャリブレーション・プログラム」などが含まれる。

【0046】

不揮発性メモリ 24 は、例えば E E P R O M (Electrically Erasable and Programmable ROM) のように電氣的に消去再書き込みが可能なメモリ素子で構成され、逐次更新すべきデータを不揮発的に保持するために使用される。逐次更新すべきデータには、暗号鍵やその他のセキュリティ情報、出荷後にインストールすべき装置制御プログラムなどが挙げられる。

【0047】

インターフェース 25 は、制御ユニット 20 外の機器と相互接続し、データ交換を可能にするための装置である。インターフェース 25 は、例えば、カメラ 15 やマイクロフォン 16、スピーカ 17 との間でデータ入出力を行なう。また、インターフェース 25 は、駆動部 50 内の各ドライバ 53 - 1 ... との間でデータやコマンドの入出力を行なう。

【0048】

また、インターフェース 25 は、R S (Recommended Standard) - 232 C などのシリアル・インターフェース、I E E E (Institute of Electrical and electronics Engineers) 1284 などのパラレル・インターフェース、U S B (Universal Serial Bus) インターフェース、i - L i n k (I E E E 1394) インターフェース、S C S I (Small Computer System Interface) インターフェース、P C カードやメモリ・スティックを受容するメモリ・カード・インターフェース (カード・スロット) などのような、コンピュータの周辺機器接続用の汎用インターフェースを備え、ローカル接続された外部機器との間でプログラムやデータの移動を行なうようにしてもよい。

【0049】

また、インターフェース 25 の他の例として、赤外線通信 (I r D A) インターフェースを備え、外部機器と無線通信を行なうようにしてもよい。

【0050】

さらに、制御ユニット 20 は、無線通信インターフェース 26 やネットワーク・インターフェース・カード (N I C) 27 などを含み、B l u e t o o t h の

ような近接無線データ通信や、IEEE 802.11bのような無線ネットワーク、あるいはインターネットなどの広域ネットワークを経由して、外部のさまざまなホスト・コンピュータとデータ通信を行なうことができる。

【0051】

このようなロボット装置1とホスト・コンピュータ間におけるデータ通信により、遠隔のコンピュータ資源を用いて、ロボット装置1の複雑な動作制御を演算したり、リモート・コントロールしたりすることができる。

【0052】

B. ステレオ・カメラの診断

本実施形態に係るロボット装置1は、ステレオ・カメラ15による距離測定に基づいて、作業空間に散在する障害物までの距離をより正確に把握してこれを回避したり、床面を特定したりその凹凸を認識して、歩行経路の修正や姿勢安定制御に活用することができる。

【0053】

他方、衝撃や経年変化によって2つのカメラの相対位置が変化し、ステレオ距離計測が正しく行えなくなるという問題がある。本実施形態では、衝撃や経年変化によって悪化したステレオ・カメラ15の診断を、自動的に、且つ簡単に行なうことができる。また、ステレオ・カメラ15の性能の悪化が認められた場合も、ユーザが簡単に高精度の再キャリブレーションを行ない、本来の距離計測性能を得ることができる。

【0054】

図3並びに図4には、ステレオ・カメラ診断マットの構成例を示している。図3は2足歩行ロボット用であり、図4は4足歩行ロボット用である。マットの表面にはステレオ・カメラ診断用テクスチャとロボットの足底を設置する場所のマークが記されているので、ユーザが間違いなく、簡単に扱うことができる。

【0055】

マットの表面のテクスチャは、ステレオ・カメラ15によって距離測定が行い易いものが好ましい。例えば、テンプレート・マッチングによるステレオ・カメラ・システムの場合、テンプレート内のテクスチャが、エピポーラ・ライン（後

述) 上で正しくマッチングを行なえるようなものがよい。

【0056】

図5～図7には、ステレオ・カメラ診断マット表面のテクスチャの例を挙げている。一般的な、テンプレート・マッチングによるステレオ・カメラ・システムの場合、診断、キャリブレーションには誤マッチングを避けられるようなテクスチャが好ましい。

【0057】

例えば図5に示すような、ランダム・ドット・パターン、フラクタル、自然画などの、均一で繰り返しの無いパターンが挙げられる。また、図6に示すような、均一なテクスチャに斜線を入れたパターンは、高精度なステレオ・カメラ診断に用いることができる。

【0058】

一方、キャリブレーション・パターンは、幾何形状が既知であれば特にパターンの形状や寸法や色彩は限定されない。計算機内での生成処理（後述）が容易な、単純な基本図形の組み合わせであれば充分である。キャリブレーション・パターンは、例えば、図7に示すような、白黒2値の市松模様や、2値の3角形の組み合わせでもよい。

【0059】

図8には、ステレオ・カメラ診断マットの使用方法を示している。ロボットをマット上の設置マークに合わせて乗せ、診断モーションを再生する。

【0060】

ステレオ・カメラ15の診断とキャリブレーションには、マットの平面性を用いるため、診断用マットが折り畳み式の場合は、広げたときに平面でなくてはならない。また、視野全体を覆う必要はないが、診断・キャリブレーションを行なうために必要とするデータを得ることが出来るほどの、十分な大きさが必要である。

【0061】

B-1. 平面検出による診断方法

図9には、平面検出によるステレオ・カメラ診断処理の手順をフローチャート

の形式で示している。診断用マットにロボットを載せた後（ステップS1）、所定のコマンドを入力することにより、ロボットは診断モーションを再生する（ステップS2）。このモーションによって、診断用マットを撮影するために適した姿勢をとる。

【0062】

この状態で、ステレオ・カメラ15から画像を取得し、距離画像を生成する（ステップS3）。距離画像は、撮像画像中の各点と投影中心との距離に応じた濃淡値が各画素に与えられた画像である。

【0063】

次いで、生成した距離画像より、診断用マットの平面を検出する（ステップS3）。

【0064】

そして、検出された平面の平面度を測定し、その平面度が基準となる平面度より高いかどうかを判断する（ステップS4）。

【0065】

検出された平面の平面度が基準となる平面度より高い場合は、ステレオ・カメラ15の性能が十分あるとして、診断はOKとなる。一方、検出された平面の平面度が低い場合は、ステレオ・カメラ15の性能が不十分であるとして、診断はNGとなる。

【0066】

ここで、ステップS4において実行される、平面度を閾値判別する具体的な方法について説明する。

【0067】

まず、平面からの距離値を閾値判別する方法が挙げられる。この場合、以下の手順に従って処理される。

【0068】

(1) ステレオ・カメラによって測定される診断マットの3次元座標を X_i ： (x_i, y_i, z_i) とする。ここで、 i は距離画像中のそれぞれの画素点番号を表す。これらの3次元座標値を用いて検出される平面の方程式を下式によって表

す。

【0069】

【数1】

$$n \cdot x + d = 0$$

【0070】

この平面と点 X_i の距離 D_i を下式のように算出する。

【0071】

【数2】

$$D_i = \frac{|n \cdot x_i + d|}{|n|}$$

【0072】

(2) 基準距離 D_{th} と D_i を比較して、 $D_{th} < D_i$ となる点の数 N_{over} をカウントする。

【0073】

(3) 基準個数 N_{th} と N_{over} を比較して、 $N_{over} < N_{th}$ となる場合は平面度が高く、 $N_{th} < N_{over}$ となる場合は平面度が低いと判定する。

【0074】

また、平面からの距離値の分散値を閾値判別する方法が挙げられる。この場合、以下の手順で処理される。

【0075】

(1) 距離画像中のそれぞれの点 i において、検出された平面からの距離 D_i を上式【数2】を用いて算出する。

【0076】

(2) すべての D_i から、平面からの距離の分散値 V_D を求める。

【0077】

【数3】

$$V_D = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (D_i - \bar{D})^2$$

D_i : i 番目の画素の平面からの距離

\bar{D} : 全画素における平面からの距離の平均

N : 画素数

【0078】

(3) 基準分散値 V_{th} と比較して、 $V_D < V_{th}$ となる場合は平面度が高く、 $V_{th} < V_D$ となる場合は平面度が低いと判定する。

【0079】

B-2. キネマティクスをとり得られる平面との比較による診断方法

図10には、キネマティクスを解いて得られる平面と、ステレオ・カメラによる距離値を比較する方法の原理を示している。

【0080】

ロボットの関節のキネマティクスを解くことによって、床面座標系を基準としたカメラ座標系への変換行列を求めることができる。この変換式から、カメラ座標系を基準とした床面の平面の方程式を求めることができる。そして、ステレオ・カメラによる距離値とキネマティクスによる平面とを比較することにより、ステレオ・カメラを診断することができる。

【0081】

図11には、キネマティクスを解いて得られる平面と、ステレオ・カメラによる距離値との比較によるステレオ・カメラの診断処理の手順をフローチャートの形式で示している。

【0082】

診断用マットにロボットを載せた後（ステップS11）、所定のコマンドを入力することにより、ロボットは診断モーションを再生する（ステップS12）。このモーションによって、診断用マットを撮影するために適した姿勢をとる。

【0083】

この状態で、ステレオ・カメラ15から画像を取得し、距離画像を生成する（ステップS13）。距離画像は、撮像画像中の各点と投影中心との距離に応じた濃淡値が各画素に与えられた画像である。

【0084】

次いで、床面からカメラまでの関節の角度を取得し（ステップS14）、ロボットの関節のキネマティクスを解くことによって、床面座標系を基準としたカメラ座標系への変換行列を求め、この変換式からカメラ座標系を基準とした床面の平面の方程式を求める（ステップS15）。

【0085】

そして、距離画像から得られた平面の平面度を測定し、ステレオ・カメラによる距離値とキネマティクスによるカメラ座標系を基準とした平面の平面度との比較により、ステレオ・カメラを診断する（ステップS16）。

【0086】

検出された平面の平面度がカメラ座標系の平面度より高い場合は、ステレオ・カメラ15の性能が十分あるとして、診断はOKとなる。一方、検出された平面の平面度が低い場合は、ステレオ・カメラ15の性能が不十分であるとして、診断はNGとなる。

【0087】

なお、平面度を比較判別する方法は上述と同様でよい。

【0088】

ここで、カメラ座標系を基準とした床面の平面方程式の求め方について説明しておく。

【0089】

カメラ座標系における任意の点の同次座標系表現は、床面座標系を基準としたカメラ座標系への変換行列を用いて、下式に示すように床面座標系を基準とした

点に変換される。

【0090】

【数4】

$${}^F X = {}^F_C P \cdot {}^C X$$

${}^C X$: カメラ座標系における任意の点の同次座標表現

${}^F_C P$: 床面座標系を基準としたカメラ座標系への変換行列

${}^F X$: ${}^F_C P$ を用いて床面座標系を基準とした点

【0091】

一方、床面座標系での床面の方程式は下式のように表すことができる。

【0092】

【数5】

$$N \cdot {}^F X = 0 \quad N = (0,0,1,0)$$

【0093】

この式に上式【数4】を代入して下式を得る。

【0094】

【数6】

$$N \cdot ({}^F_C P \cdot {}^C X) = 0$$

【0095】

ここで、 N' を以下の通りとする。

【0 0 9 6】

【数 7】

$$N' = ({}^F P_{31}^C, {}^F P_{32}^C, {}^F P_{33}^C, {}^F P_{34}^C)$$

【0 0 9 7】

すると、下式が導かれ、カメラ座標系を基準とした床面の平面方程式は【数 7】のように表現される。

【0 0 9 8】

【数 8】

$$N' \cdot {}^C X = 0$$

【0 0 9 9】

この手法により得られた平面の方程式【数 7】を、B-1 項で説明した、検出した平面の代わりに用いることで、ステレオ・カメラの診断を行なうことができる。

【0 1 0 0】

B-3. 均一のテクスチャに斜線がある診断用マットを用いた診断方法

ここで、ステレオ法の基本的な仕組みについて説明する。2 台のカメラでステレオ・カメラ 1 5 が構成される場合、1 つのカメラは基準カメラとして使用され、正面と正対した位置から対象物を撮像して、基準画像を出力する。また、他方のカメラは参照カメラとして使用され、斜め方向から対象物を撮像して、参照画像を出力する。図 1 2 には、撮像対象に対する基準カメラと参照カメラの配置を模式的に示しており、また、図 1 3 には、略正方形のパターンを基準カメラと参照カメラそれぞれによって撮像した場合の基準画像と参照画像を模式的に示して

いる。

【0101】

図13に示すように、略正方形のパターンに正対する基準カメラで撮像した撮像画像は正方形となる。これに対し、このパターンを斜視する参照カメラで撮像した画像は、視点からの距離が長い辺が縮小される結果として、台形として現れる。これは、同じ大きさの物体であっても、カメラの投影中心Cに近づくにつれて大きな像として投影され、逆に、投影中心Cから遠ざかるにつれて小さく投影されるという、中心投影の基本的性質に依拠する。

【0102】

また、基準カメラの視線は、参照カメラの投影スクリーン S_d 上では「エピポーラ・ライン」と呼ばれる直線として現れる（図12を参照のこと）。基準カメラの視線上に存在する点Pは、点Pの奥行き、すなわち基準カメラとの距離の大小に拘らず、基準カメラの投影スクリーン S_b 上では同じ観察点 n_b 上に現れる。これに対し、参照カメラの投影スクリーン S_d 上における点Pの観察点 n_d は、エピポーラ・ライン上で基準カメラと観察点Pとの距離の大小に応じた位置に現れる。

【0103】

図14には、エピポーラ・ラインと、参照カメラの投影スクリーン S_d 上における観察点 n_d の様子を図解している。同図に示すように、点Pの位置が P_1 , P_2 , P_3 へと変化するに従って、参照画像中の観察点は n_{d1} , n_{d2} , n_{d3} へとシフトする。言い換えれば、エピポーラ・ライン上の位置が観察点Pの奥行きに相当する訳である。このような幾何光学的性質を利用して、基準カメラの観察点 n_b に対応する観察点 n_d をエピポーラ・ライン上で探索することにより、点Pの距離を同定することができる。これが「ステレオ法」の基本的原理である。

【0104】

ここで、図6に示したような、均一のテクスチャに斜線がある診断用マットを用いて、テンプレート・マッチングによるステレオ・カメラを診断したとする。

【0105】

経年変化などによりカメラ位置がずれたステレオ・カメラで距離計測を行なう

と、図15に示すように、正しいエピポーラ・ラインよりも近距離又は遠距離に観測される（図示の例では、遠距離に計測される）。

【0106】

この特性を利用すると、微小なエピポーラ・ラインのずれを計測距離の差として測定できるため、ステレオ・カメラのより精密な診断を行なうことができる。

【0107】

図16には、均一のテクスチャに斜線がある診断用マットを用いたステレオ・カメラの診断処理の手順をフローチャートの形式で示している。

【0108】

図6に示した診断用マットにロボットを載せた後（ステップS21）、所定のコマンドを入力することにより、ロボットは診断モーションを再生する（ステップS22）。このモーションによって、診断用マットを撮影するために適した姿勢をとる。

【0109】

この状態で、ステレオ・カメラ15から画像を取得し、距離画像を生成する（ステップS23）。距離画像は、撮像画像中の各点と投影中心との距離に応じた濃淡値が各画素に与えられた画像である。

【0110】

次いで、斜線付近の距離値と基準平面を比較する（ステップS24）。ここで言う基準平面は、例えば、B-1又はB-2項で説明した処理により得られた平面である。

【0111】

そして、距離値と基準平面との差異が閾値以内であれば、ステレオ・カメラ15の性能が十分あるとして、診断はOKとなる。一方、閾値を越える場合には、ステレオ・カメラ15の性能が不十分であるとして、診断はNGとなる。

【0112】

B-4. マッチング・スコア値からステレオ・カメラを診断する方法

テンプレート・マッチング方法によるステレオ・カメラの場合、図14に示したように、基準カメラ画像中のテンプレートを、検出カメラ画像中でエピポーラ

・ラインに沿って探索する。この際に、それぞれのテンプレートに対してエピポーラ・ラインに沿って、相関値を表すマッチング・スコアを得ることができる。図17には、マッチング・スコアの例として、輝度差の総和のグラフを示している。図示の例では、スコア値が低いほど、相関が高いことを表している。

【0113】

衝撃や経年変化などでステレオ・カメラ間の位置関係がずれた場合、エピポーラ・ライン上で正しいマッチングが得られなくなるため、マッチング・スコア値が高くなる。この値を判定することで、ステレオ・カメラの診断が行なうことができる。

【0114】

マッチング・スコア値からエピポーラ・ラインのずれを判定する方法の例を以下に示す。

【0115】

- (1) 画像の各画素 i に対する最小のマッチング・スコア値 M_i を算出する。
- (2) 基準スコア値 M_{th} と M_i を比較して、 $M_{th} < M_i$ となる点の数 N_{over} をカウントする。
- (3) 基準個数 N_{th} と N_{over} を比較して、 $N_{over} < N_{th}$ となる場合はエピポーラ・ラインのずれが小さく、 $N_{th} < N_{over}$ となる場合はずれが大きいと判定する。

【0116】

図18には、マッチング・スコア値からステレオ・カメラを診断する処理手順をフローチャートの形式で示している。

【0117】

まず、診断用マットにロボットを載せた後（ステップS31）、所定のコマンドを入力することにより、ロボットは診断モーションを再生する（ステップS32）。

【0118】

次いで、各テンプレートに対するマッチング・スコア値を算出し（ステップS33）、マッチング・スコア値と基準値を比較して、エピポーラ・ラインのずれ

を判定する（ステップ S 3 4）。

【0119】

そして、エピポーラ・ラインのずれが小さいかどうかを判別する（ステップ S 3 5）。エピポーラ・ラインのずれが十分に小さければ、ステレオ・カメラ 1 5 の性能が十分あるとして、診断は OK となる。一方、エピポーラ・ラインのずれが大きい場合には、ステレオ・カメラ 1 5 の性能が不十分であるとして、診断は NG となる。

【0120】

B-5. モーションを再生して複数の診断結果を得る方法

診断マット上でモーションを再生し、複数の角度や距離から得られたデータを用いて（図 1 9 を参照のこと）、ステレオ・カメラの診断性能を上げることができる。

【0121】

C. ステレオ・カメラのキャリブレーション方法

ステレオ法に基づいて複数台のカメラによる複数の画像から物体の距離を計測することは、カメラが持つ撮像光学系が理論と完全に一致する特性を持っていることを前提としている。このため、実写により取得した画像に対して所定の補正を施す必要である。例えば、カメラのレンズは一般に歪みパラメータを有し、観察点は理論上の点から変位した位置に結像される。したがって、カメラ特有のパラメータを算出し、射影変換に際してこのパラメータに従った画像データの補正を行わなければ、正面画像から正確な射影画像を得ることができず、また、ステレオ法により正確な奥行き計測を行なうことができない。

【0122】

カメラが持つパラメータは、レンズの歪みパラメータの他、カメラ特性をあらわす内部パラメータ、カメラの 3 次元位置を示す外部パラメータに区分される。これらカメラのパラメータを算出する方法のことを、一般に、「カメラ・キャリブレーション」と呼ぶ。

【0123】

図 2 0 には、診断用マットを用いたカメラ・キャリブレーション処理の手順を

フローチャートの形式で示している。

【0124】

まず、診断用マットにロボットを載せた後（ステップS41）、所定のコマンドを入力することにより、ロボットはキャリブレーション・モーションを再生する（ステップS42）。そして、この状態で、ステレオ・カメラ15から画像を取得する（ステップS43）。

【0125】

このような処理をキャリブレーションに必要な枚数の画像を取得するまで、繰り返し実行する（ステップS44）。キャリブレーション方法にも依存するが、異なる角度からの画像が必要な場合は、必要な角度から画像が得られるようなモーションを再生する。

【0126】

そして、キャリブレーションに必要な画像がすべて得られたら、キャリブレーション・パラメータを算出する（ステップS45）。

【0127】

以下では、ステップS45におけるキャリブレーション・パラメータの算出方法の一例を、図21を参照しながら説明する。

【0128】

まず、幾何形状の定義に基づいてキャリブレーション・パターンを合成して、この合成画像を基準画像 I_0 としてフレーム・メモリに格納する（ステップS51）。

【0129】

次いで、キャリブレーション・パターンが形成された診断用マットを、基準カメラ及び参照カメラによって撮像する。各カメラが撮像した濃淡画像 I_A 及び I_B は、フレーム・メモリに一時格納される（ステップS52）。診断用マット上に形成されたパターンは、キャリブレーションに用いるキャリブレーション・パターンであり、その幾何形状は基準画像 I_0 の定義とは一義的である。

【0130】

キャリブレーション・パターンは、幾何形状が既知であれば特にパターンの形

状や寸法や色彩は限定されず、画像合成処理が容易な、単純な基本図形の組み合わせであれば充分である（前述）。ここでは、図7に示すような白黒2値の市松模様のテクスチャ付き平面が用いられているものとする。このテクスチャ付き平面と各カメラまでの距離は限定されない。

【0131】

次いで、基準画像 I_0 と撮像画像 I_A との対応関係の初期値を設定する（ステップ S53A）。この対応関係は、射影変換行列 H_A によって記述される。但し、この時点では、基準カメラのレンズ歪みについては考慮せず、2枚の画像間の対応を設定するだけでよい。初期値としては、4点以上の対応点の設定が可能であればよく、設定方法を特に限定する必要はない。

【0132】

次いで、画像合わせ込み処理を効率的且つ高精度に行なうために、撮像画像 I_A の輝度値を用いて基準画像 I_0 の輝度値を補正する（ステップ S54A）。

【0133】

次いで、Levenberg-Marquardt 最小化法を用いて画像合わせ込み（Image Registration）を行ない、射影変換行列 H_A と歪みパラメータ κ_A , C_{xA} , C_{yA} を算出する（ステップ S55A）。但し、 κ_A は基準カメラのレンズ歪み係数であり、点 (C_{xA}, C_{yA}) はレンズの歪み中心である。

【0134】

また、他方の参照カメラの撮像画像 I_B に対しても、同様に、基準画像 I_0 との対応関係の初期値の設定（ステップ S53B）、撮像画像 I_B の輝度地を用いた基準画像 I_0 の輝度値の補正（ステップ S54B）、及び、射影変換行列 H_B と歪みパラメータ κ_B , C_{xB} , C_{yB} の算出（ステップ S55B）を行なう。

【0135】

基準カメラの撮像画像 I_A から参照カメラの撮像画像 I_B への射影変換行列 H_{trans} は、 $H_A \times H_B^{-1}$ という形で表すことができる（ステップ S57）。この射影変換処理の前後において、歪みパラメータ κ_A , C_{xA} , C_{yA} を用いて撮像画像 I_A の歪みを除去する（ステップ S56）とともに、歪みパラメータ κ_B , C_{xB} , C_{yB}

Bを用いて撮像画像 I_B 相当の歪みを付加する（ステップ S 57）。

【0136】

なお、画像合わせ込みを行う際に、それぞれの画像の座標系を一致させる必要がある（すなわち、カメラ 17A 及び 17B の各々の撮像画像 I_A , I_B において、対応する正方形が基準画像 I_0 の同じ正方形と合わせ込まれる必要がある）。そこで、キャリブレーション・パターン中に 1 箇所（又は数箇所）に特別なパターンを設けて、各画像間の整合をとるようにしてもよい。

【0137】

[追補]

以上、特定の実施例を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施例の修正や代用を成し得ることは自明である。

【0138】

本発明の要旨は、必ずしも「ロボット」と称される製品には限定されない。すなわち、電氣的若しくは磁氣的な作用を用いて人間の動作に似せた運動を行なう機械装置あるいはその他一般的な移動体装置であるならば、例えば玩具などのような他の産業分野に属する製品であっても、同様に本発明を適用することができる。

【0139】

要するに、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、本明細書の記載内容を限定的に解釈するべきではない。本発明の要旨を判断するためには、冒頭に記載した特許請求の範囲の欄を参酌すべきである。

【0140】

【発明の効果】

以上詳記したように、本発明によれば、ロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの経年変化や機体の転倒などに伴うカメラ位置ずれなどの診断を支援することができる、優れたステレオ・カメラ診断補助装置、並びにロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの診断方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明に実施に供されるロボット装置 1 の機能構成を模式的に示した図である。

【図 2】

制御ユニット 20 の構成をさらに詳細に示した図である。

【図 3】

ステレオ・カメラ診断マットの構成例を示した図である。

【図 4】

ステレオ・カメラ診断マットの構成例を示した図である。

【図 5】

ステレオ・カメラ診断マット表面のテクスチャの例を示した図である。

【図 6】

ステレオ・カメラ診断マット表面のテクスチャの例を示した図である。

【図 7】

ステレオ・カメラ診断マット表面のテクスチャの例を示した図である。

【図 8】

ステレオ・カメラ診断マットの使用方法を示した図である。

【図 9】

平面検出によるステレオ・カメラ診断方法を示した図である。

【図 10】

キネマティクスを解いて得られる平面と、ステレオ・カメラによる距離値を比較する方法の原理を説明するための図である。

【図 11】

キネマティクスを解いて得られる平面と、ステレオ・カメラによる距離値との比較によるステレオ・カメラの診断処理の手順を示したフローチャートである。

【図 12】

撮像対象に対する基準カメラと参照カメラの配置を模式的に示した図である。

【図 13】

略正方形のパターンを基準カメラと参照カメラの各々によって撮像した場合の

基準画像と参照画像を模式的に示した図である。

【図 1 4】

エピソード・ラインと、参照カメラの投影スクリーン S_d 上における観察点 n_d E の様子を示した図である。

【図 1 5】

均一のテクスチャに斜線がある診断用マットによる診断方法を説明するための図である。

【図 1 6】

均一のテクスチャに斜線がある診断用マットを用いたステレオ・カメラの診断処理の手順を示したフローチャートである。

【図 1 7】

マッチング・スコアの例を示した図である。

【図 1 8】

マッチング・スコア値からステレオ・カメラを診断する処理手順を示したフローチャートである。

【図 1 9】

モーションを再生して複数の診断結果を得る方法を示した図である。

【図 2 0】

診断用マットを用いたカメラ・キャリブレーション処理の手順を示したフローチャートである。

【図 2 1】

キャリブレーション・パラメータの算出方法の一例を示したフローチャートである。

【符号の説明】

1…ロボット装置

1 5…CCDカメラ

1 6…マイクロフォン


1 7…スピーカ

1 8…タッチ・センサ


1 9 … L E D インジケータ
2 0 … 制御部
2 1 … C P U
2 2 … R A M
2 3 … R O M
2 4 … 不揮発メモリ
2 5 … インターフェース
2 6 … 無線通信インターフェース
2 7 … ネットワーク・インターフェース・カード
2 8 … バス
2 9 … キーボード
4 0 … 入出力部
5 0 … 駆動部
5 1 … モータ
5 2 … エンコーダ
5 3 … ドライバ

【書類名】 図面


【図 1】

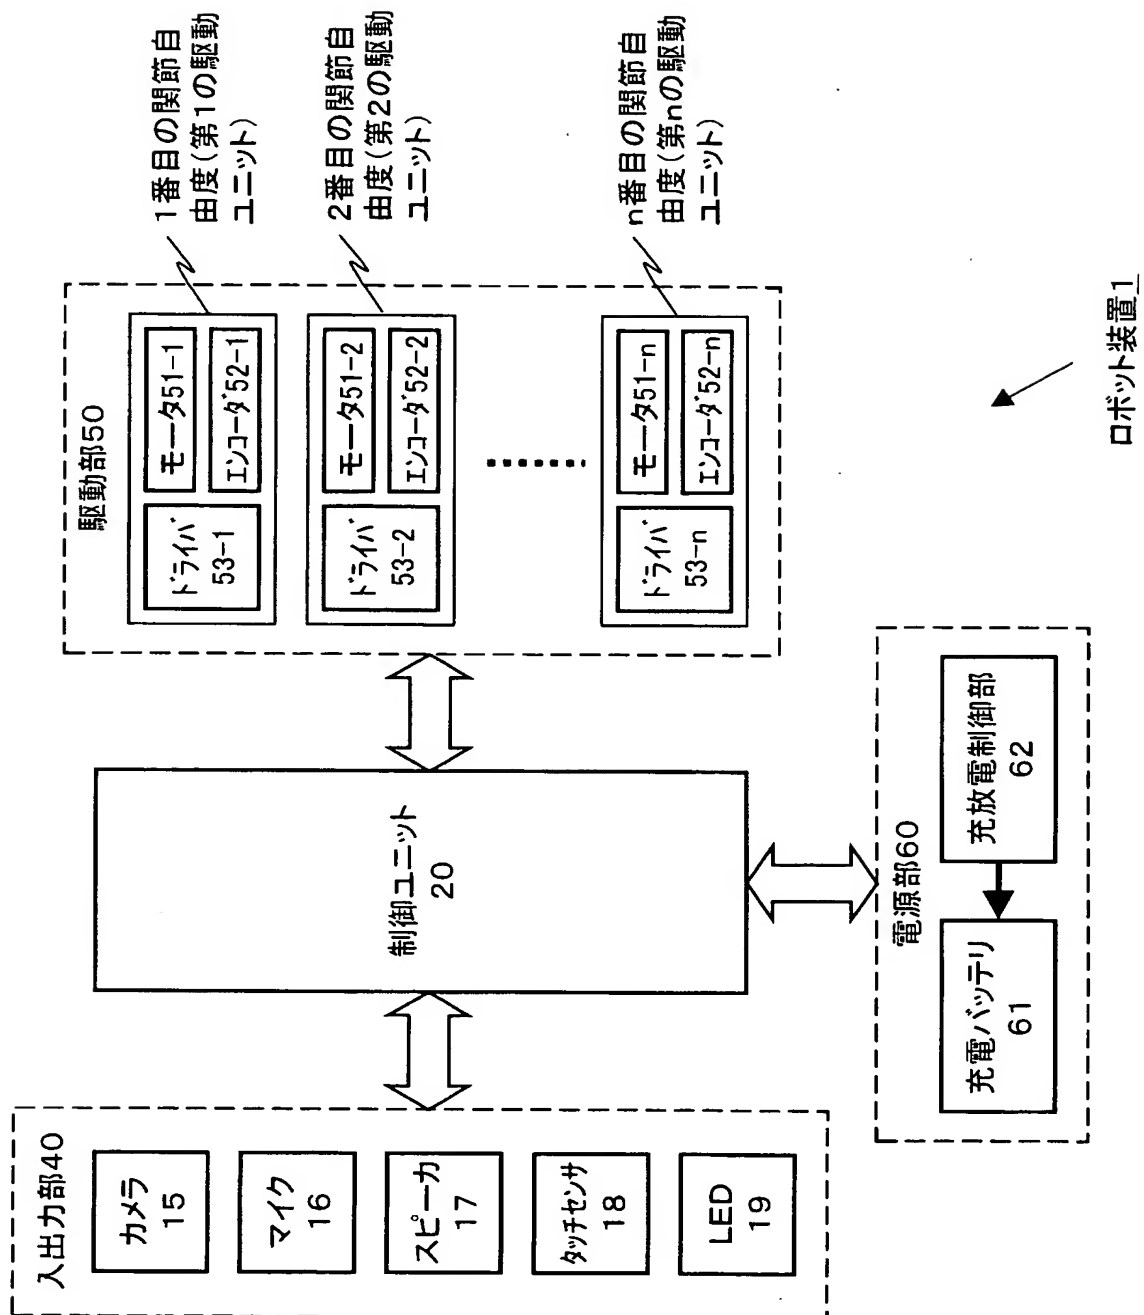


【図 2】

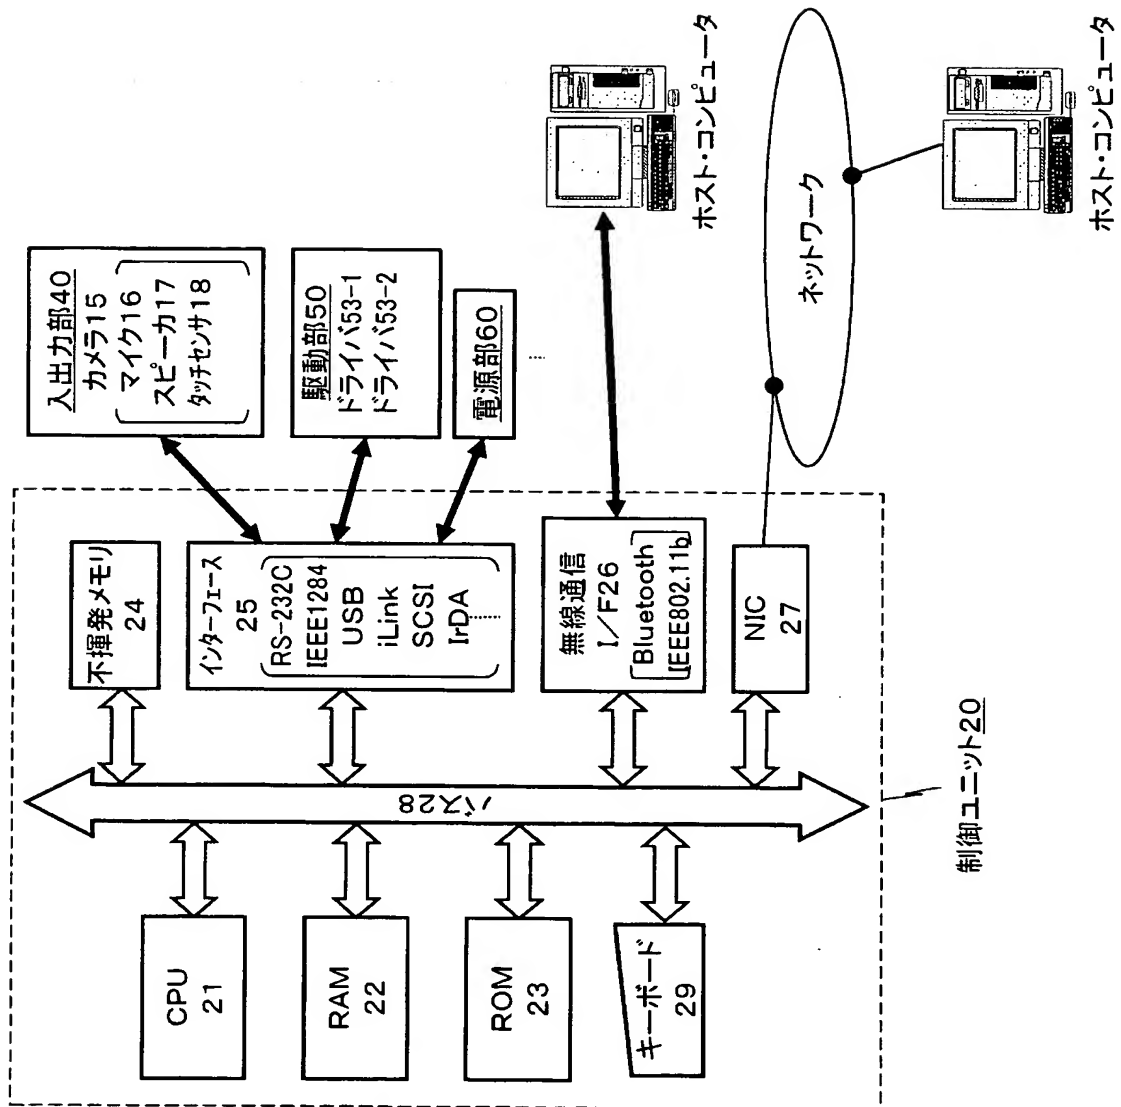


【図 3】

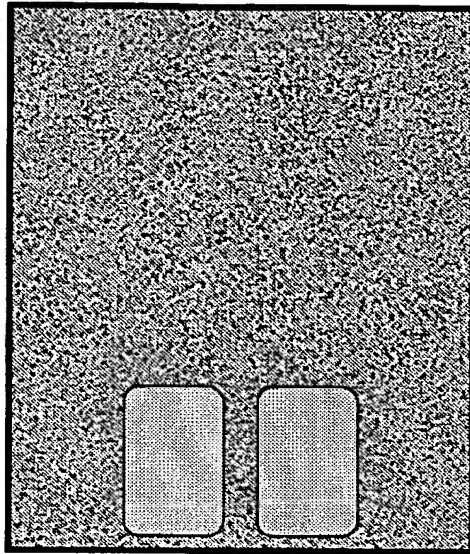


【図 4】

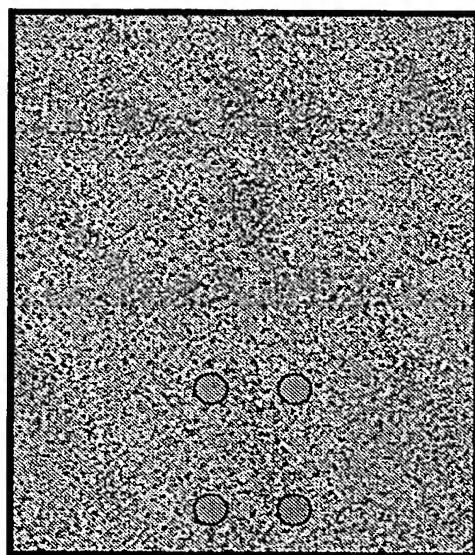


【図 5】

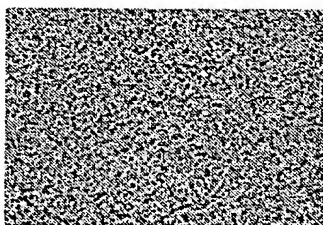

ランダムドット

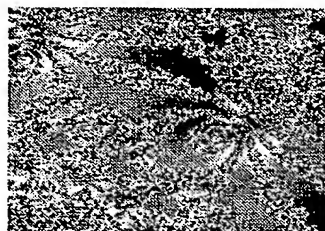


フラクタル

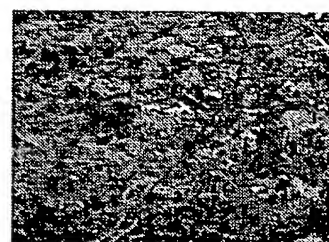


自然画

【図 6】

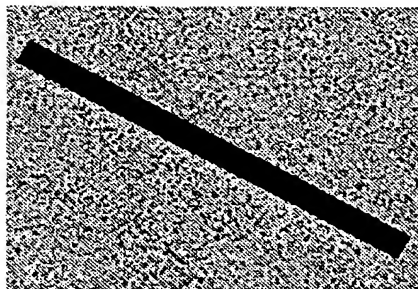


【図 7】

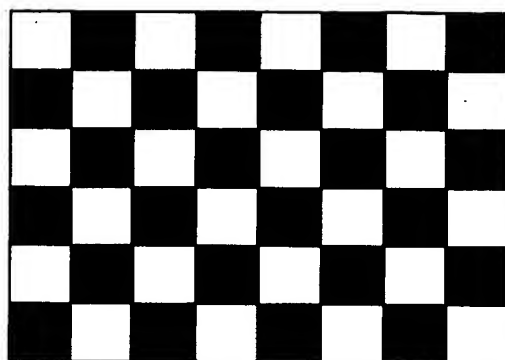


2値の市松模様


【図 8】

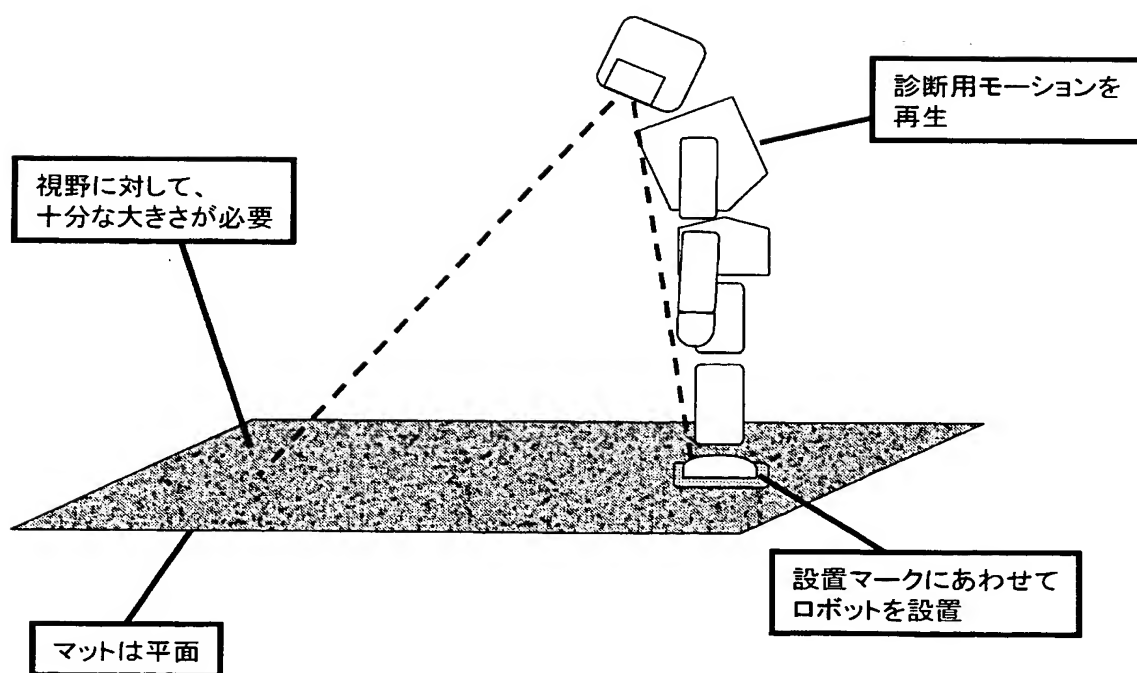


【図 9】

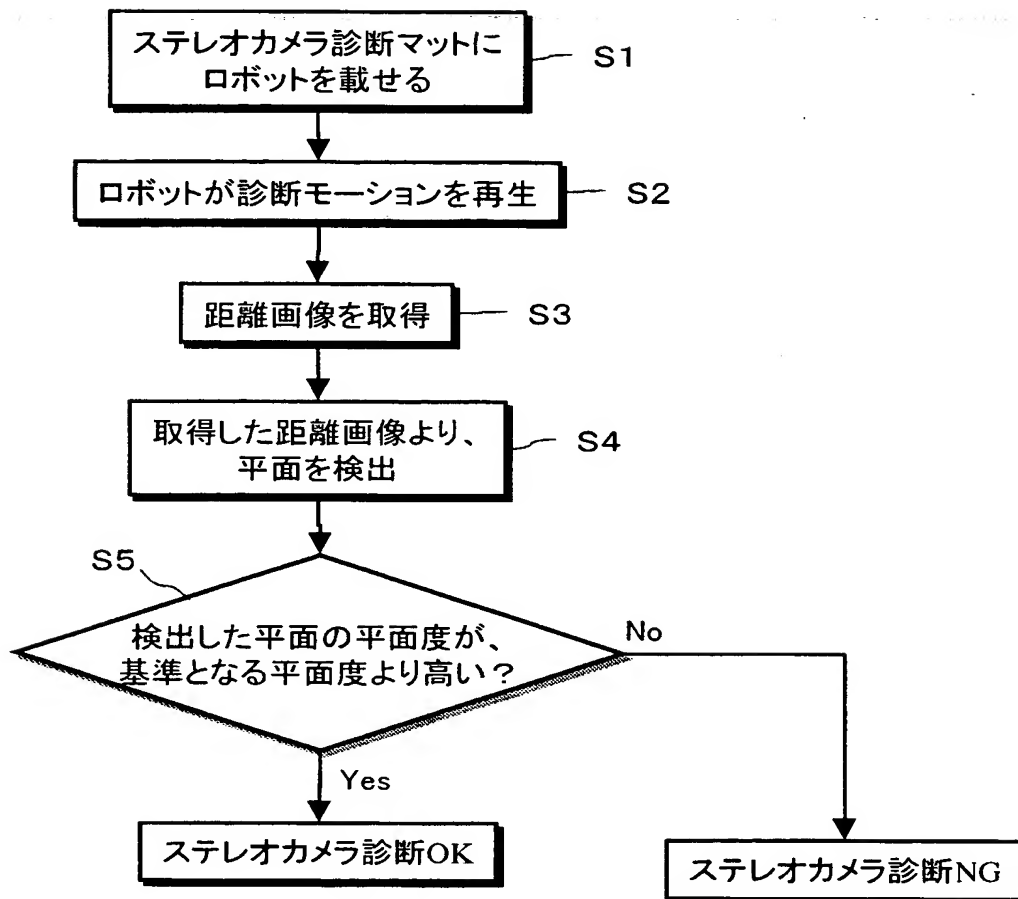


【図 10】

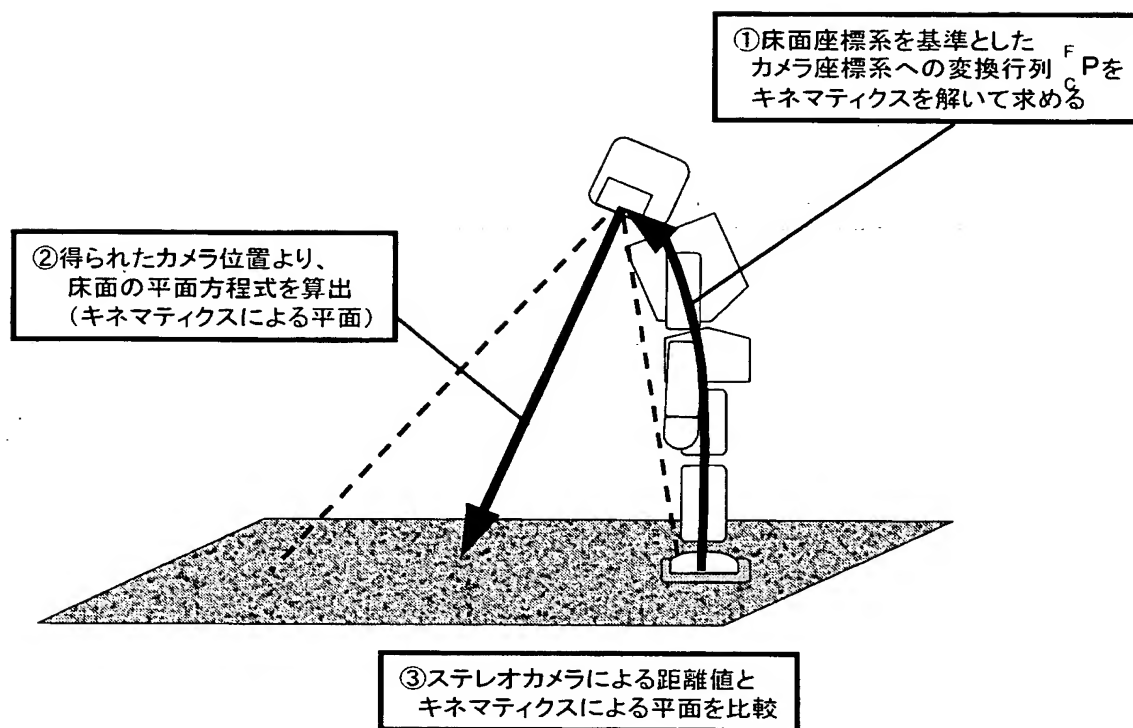


【図 11】

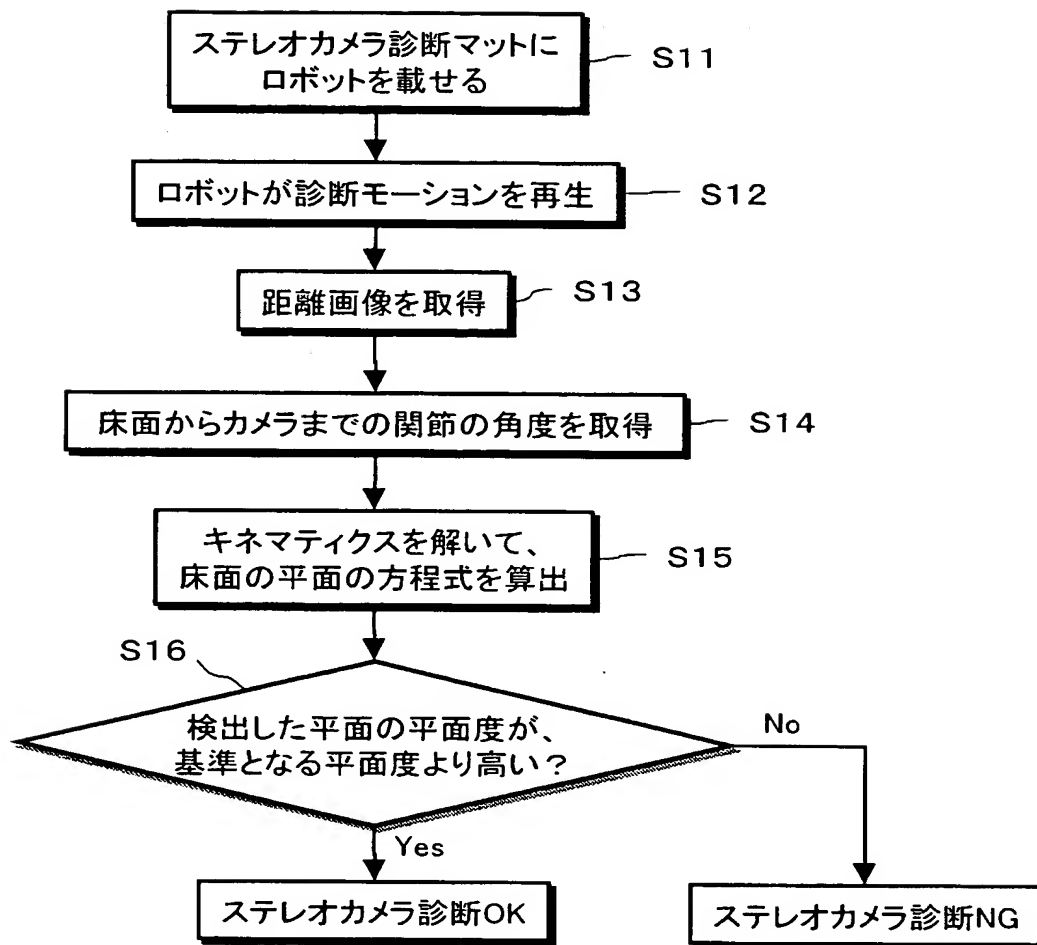


【図 12】

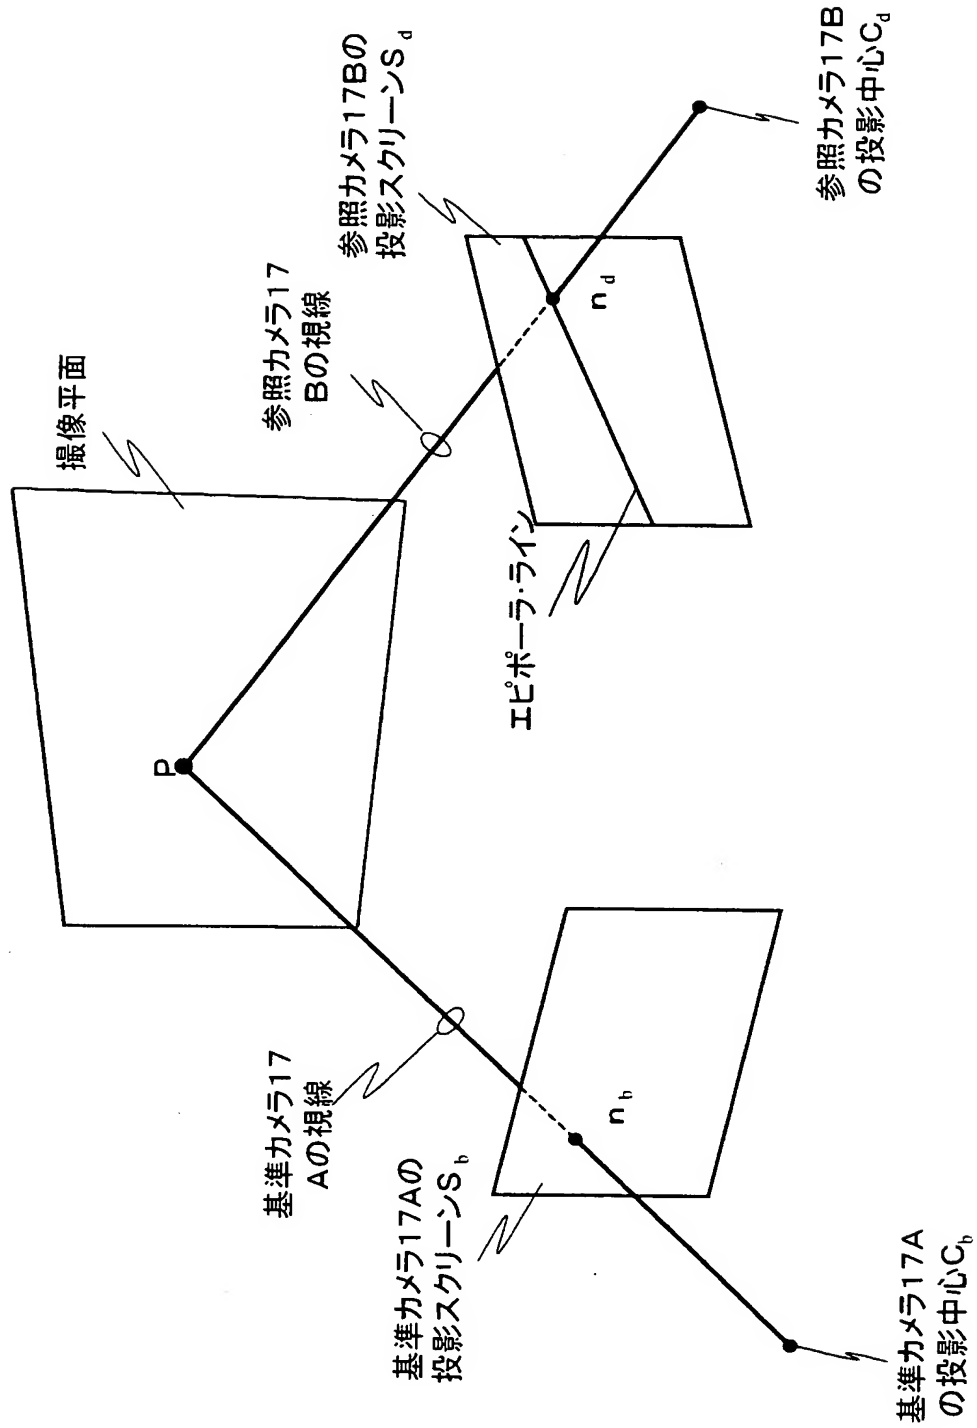


【図 13】

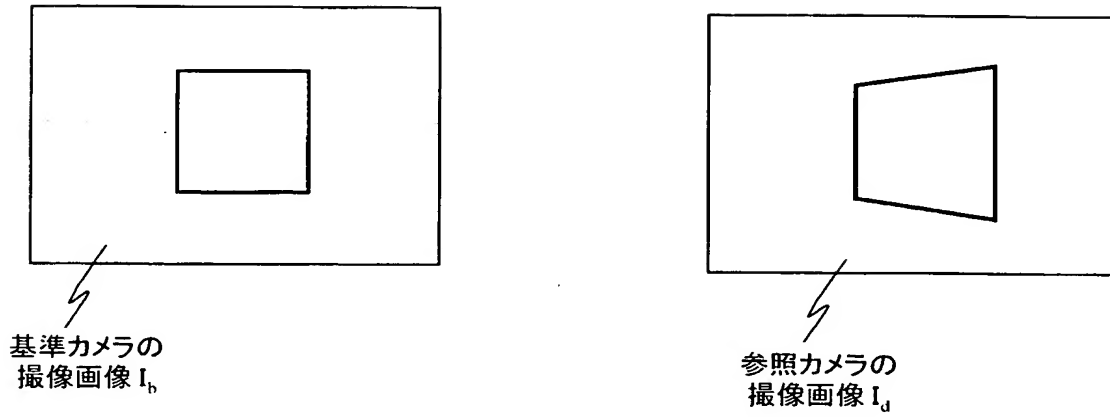


【図 14】

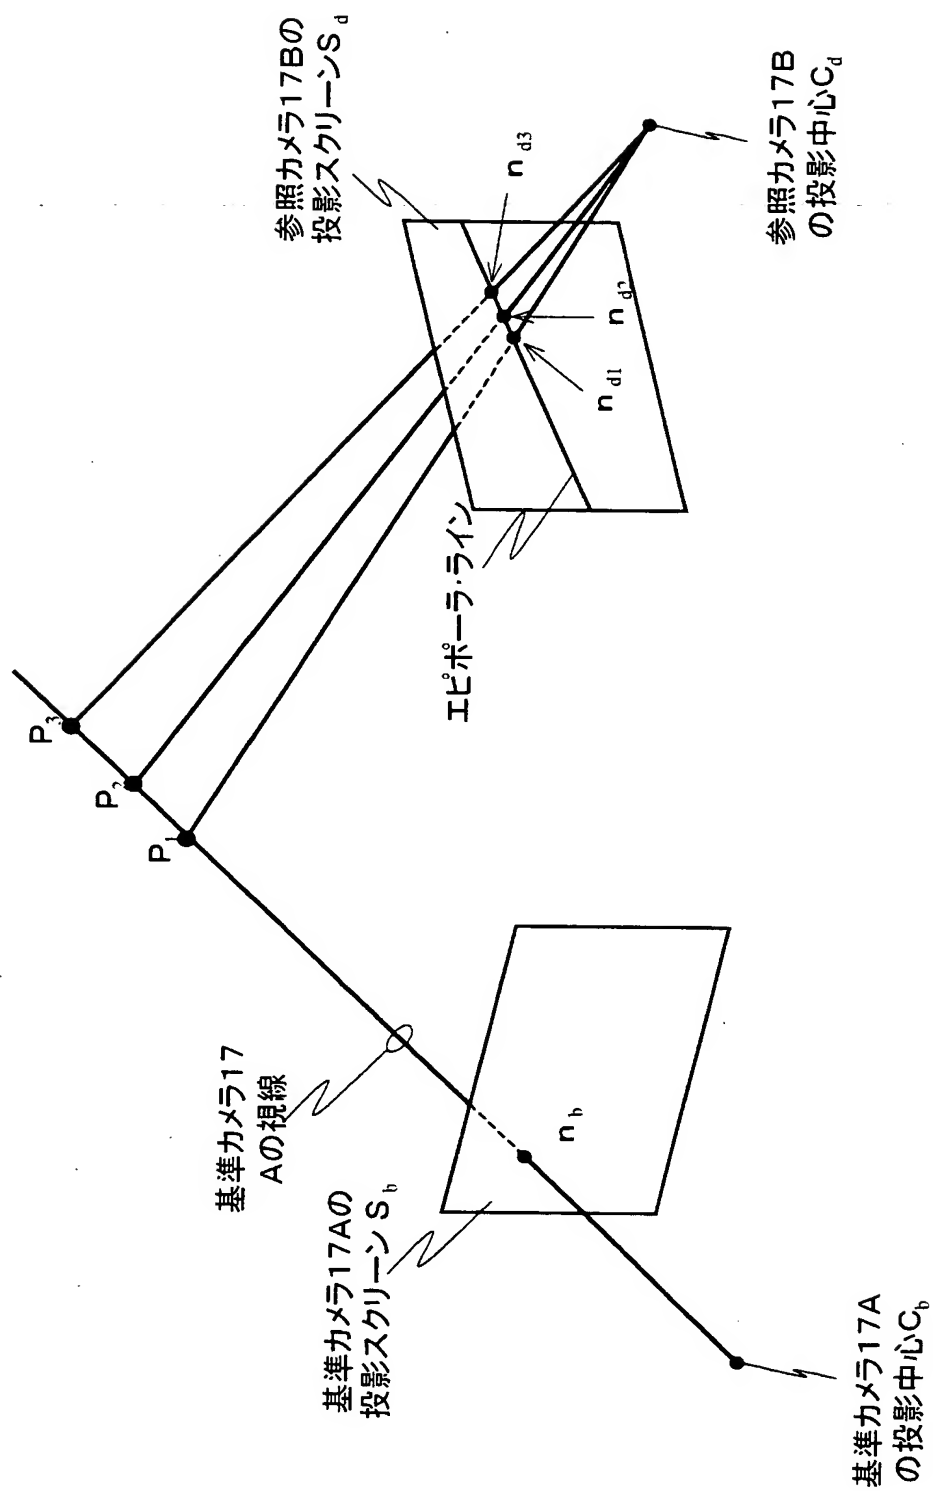


【図 15】

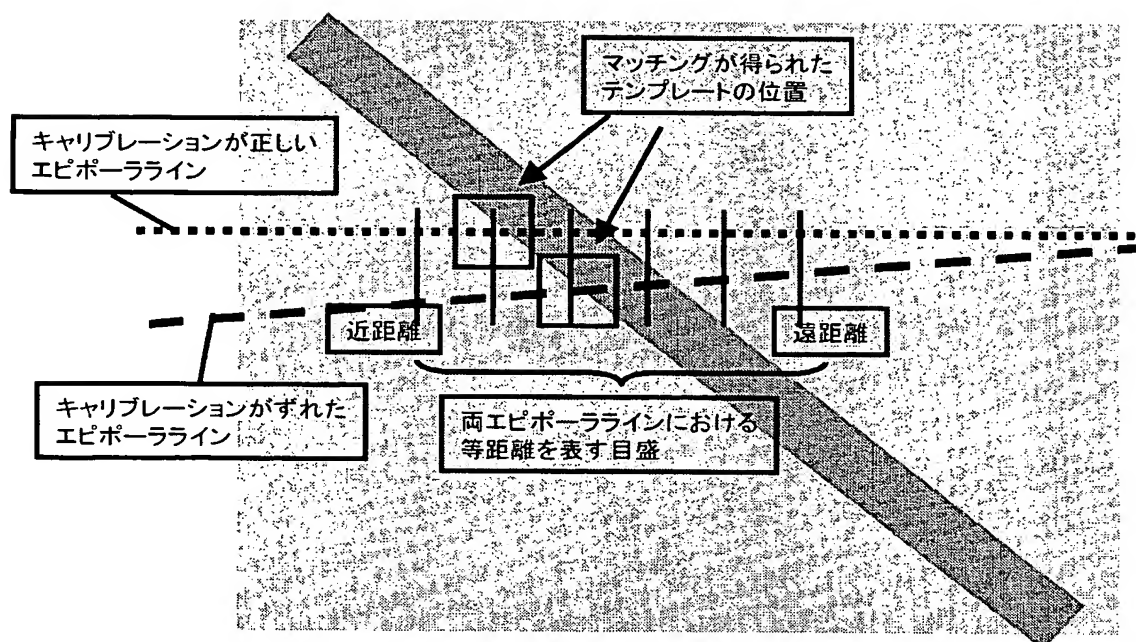


【図 16】

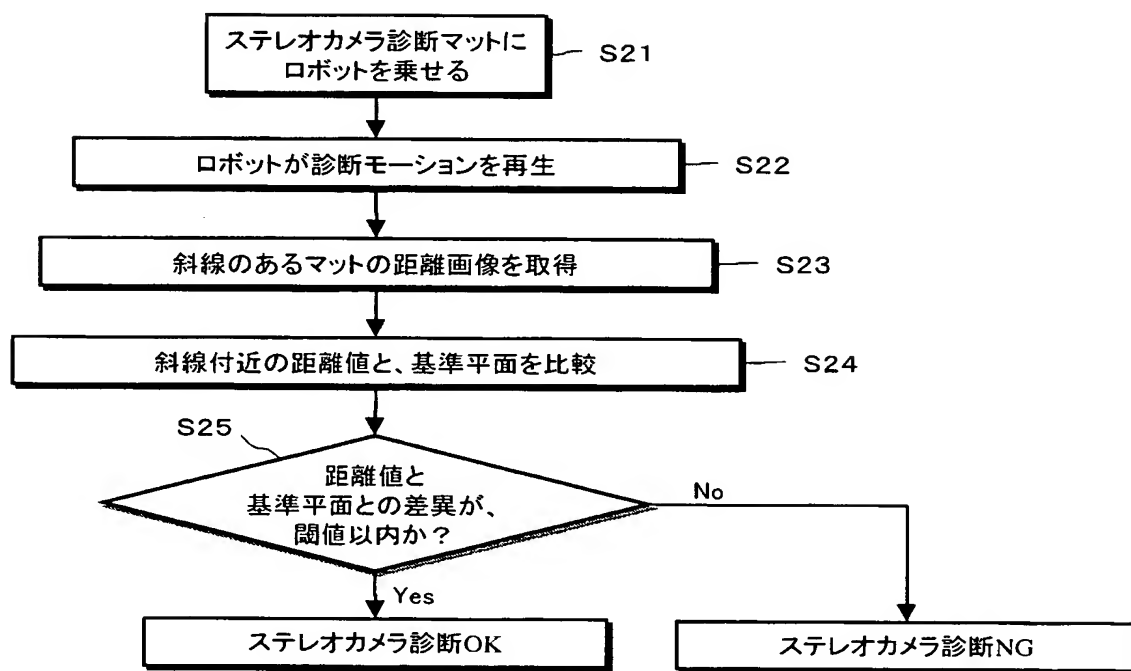


【図 1 7】

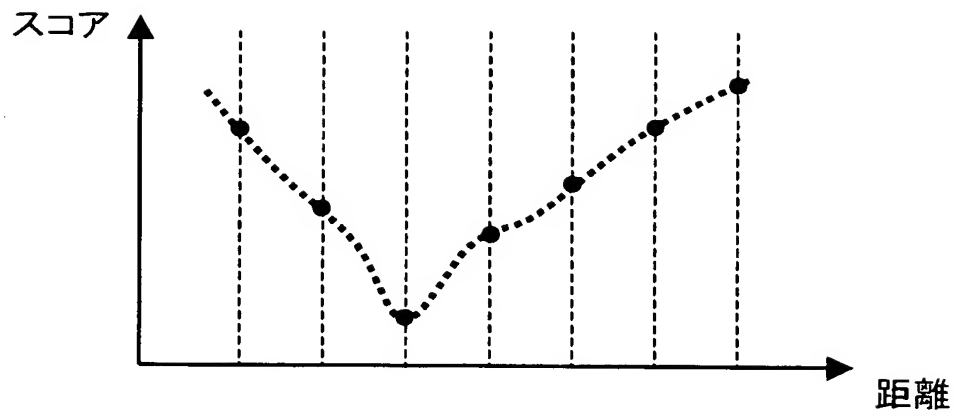


【図 18】

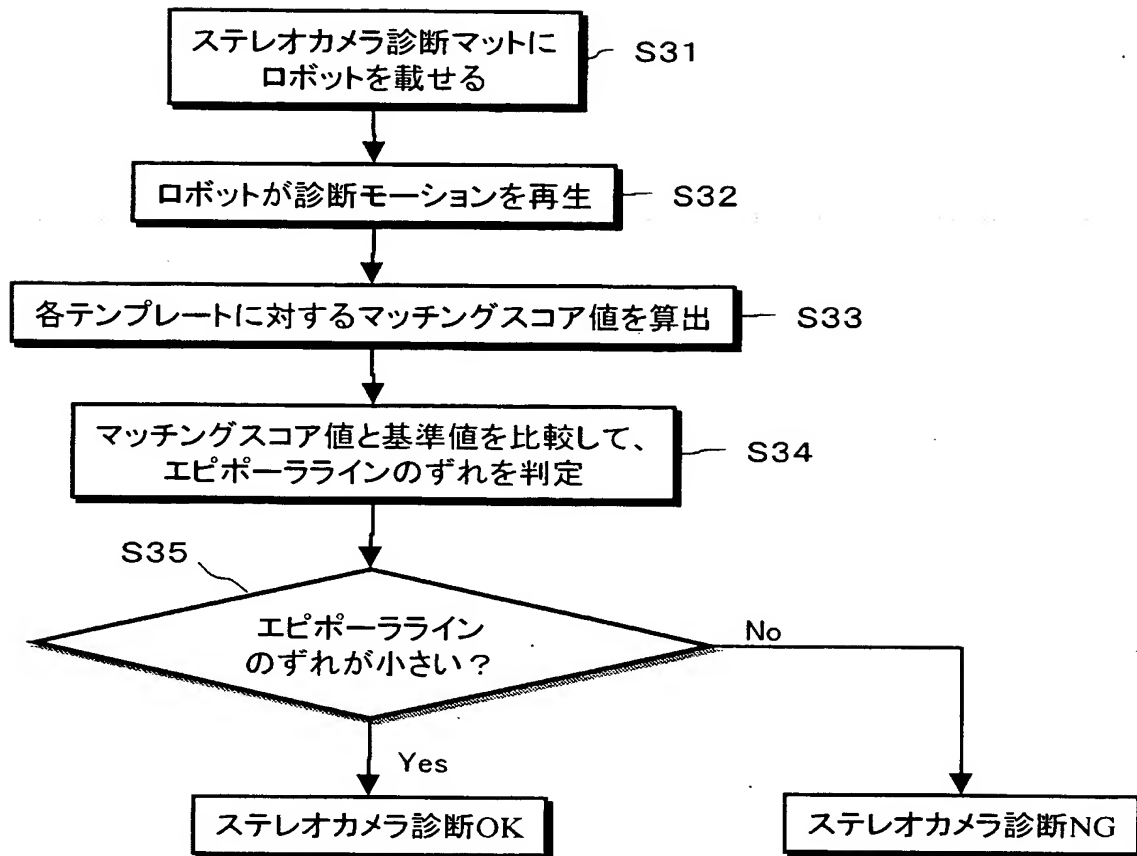


【図 19】

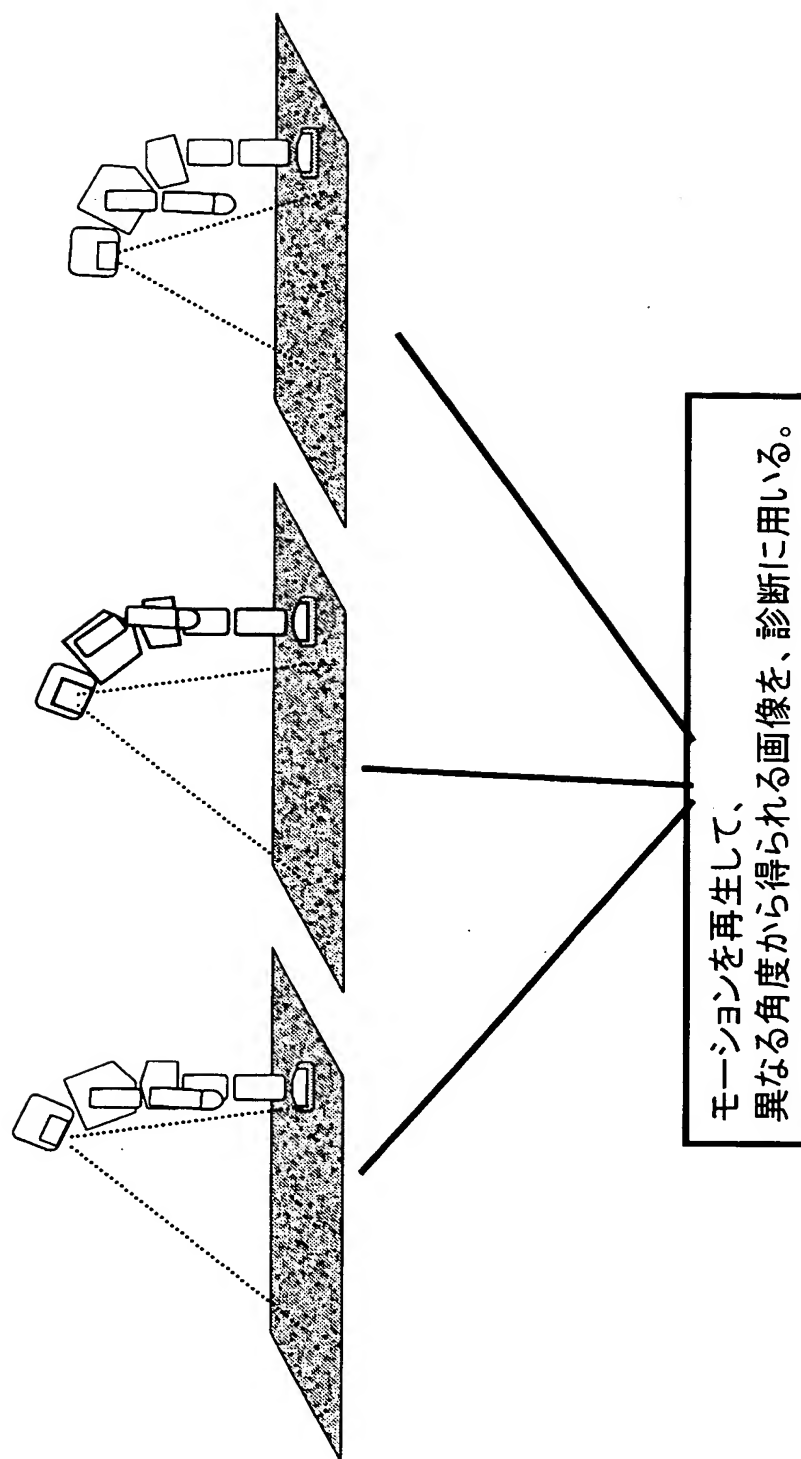

【図 20】

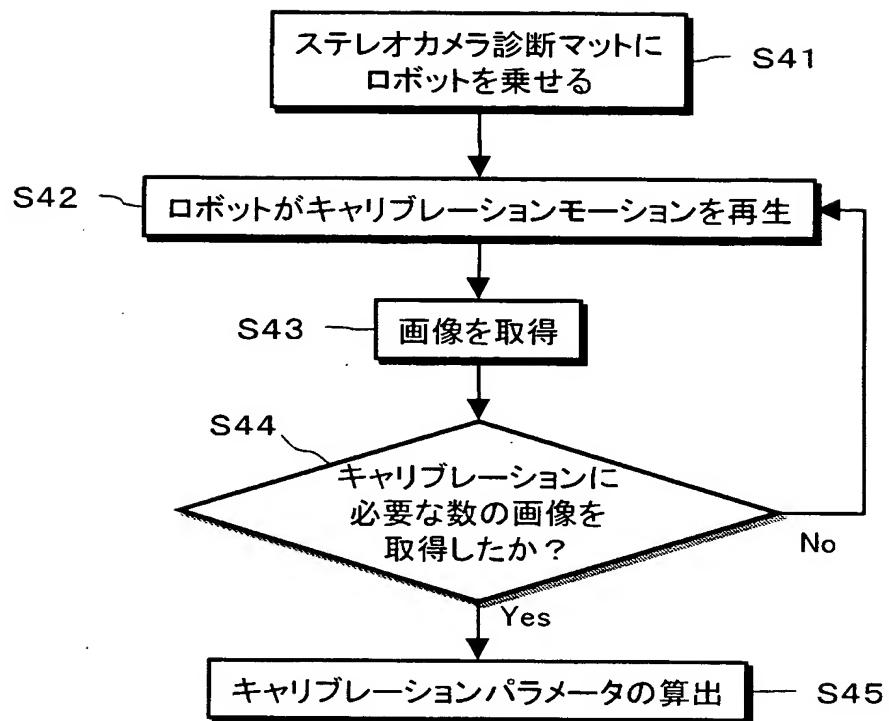

【図 21】

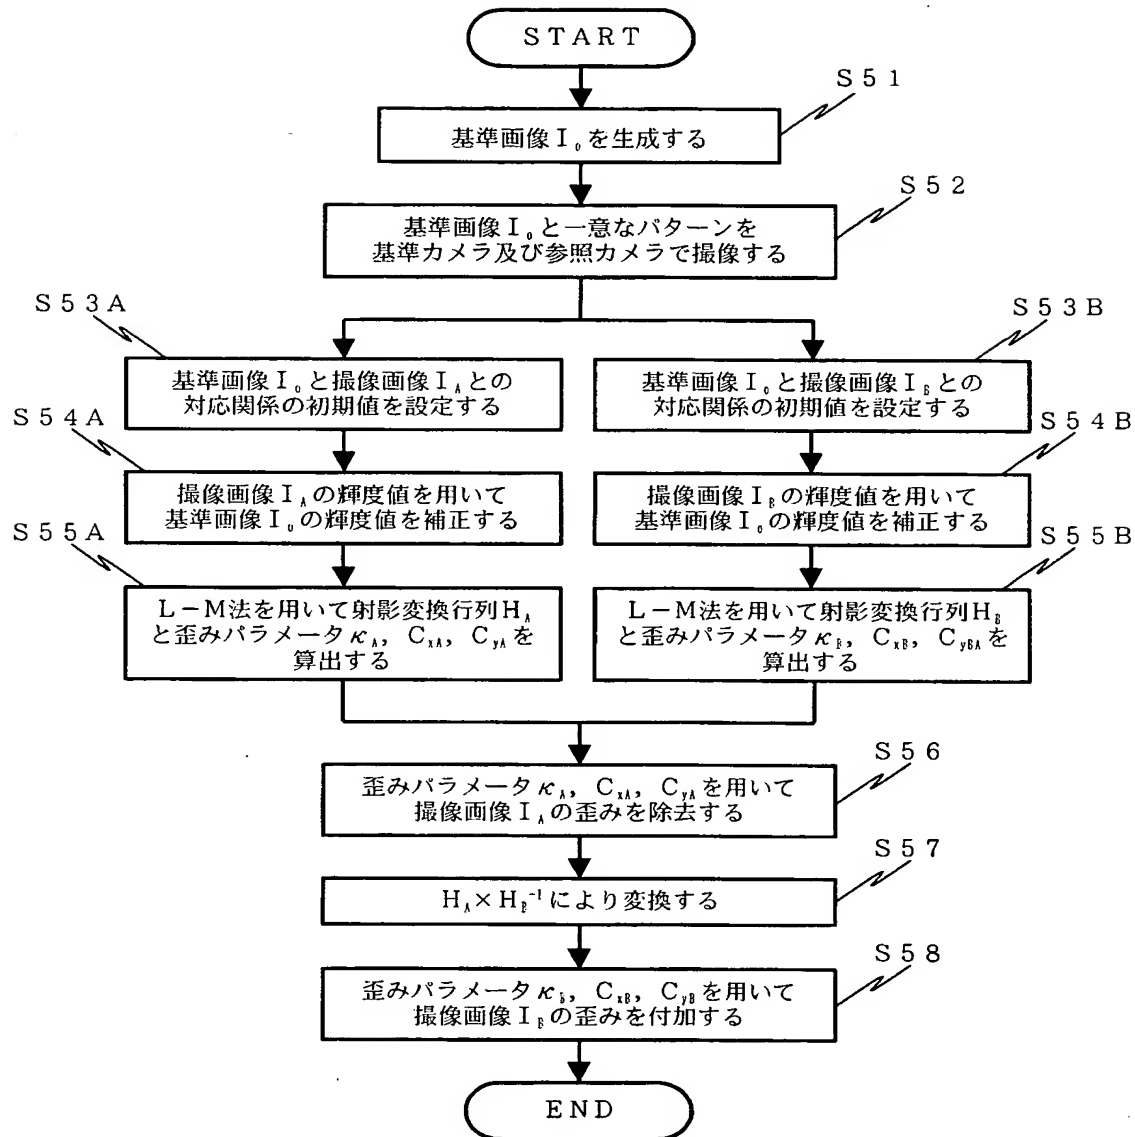

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ロボット装置に搭載されたステレオ・カメラの経年変化や機体の転倒などに伴うカメラ位置ずれなどの診断を支援する。

【解決手段】 診断用マットは、ランダム・ドット・パターン、フラクタル、自然画などの、均一で繰り返しの無いパターンなど、診断、キャリブレーションにおいて誤マッチングを避けられるようなテクスチャを備える。診断マット上に設置されたロボットは診断用マットを撮影するために適した姿勢をとり、ステレオ・カメラにおいて取得した画像から距離画像を生成し、この距離画像から得られる診断用マットの平面度に基づいて、ステレオ・カメラの性能を検証する。

【選択図】 図 8

特願 2 0 0 3 - 0 8 6 6 2 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 1 8 5]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号

氏 名

ソニー株式会社